

TV non soutenue Episode n° 324

Dispositif : **Protecta XT VR D354VRM**

Numéro de série :

Date de la visite : **27-Sep-2016 11:34:51**

Patient :


ID :

Cardiologue :

Type	SAT Séq.	Chocs	Succès	N° ID	Date	Heure hh:mm	Durée hh:mm:ss	Min ⁻¹ moy. V	Min ⁻¹ max. V	Activité en Début
TV-NS				324	23-Jun-2016	12:17	:01	207		Actif

• V-V FV = 260 ms TV = 390 ms

Stop.

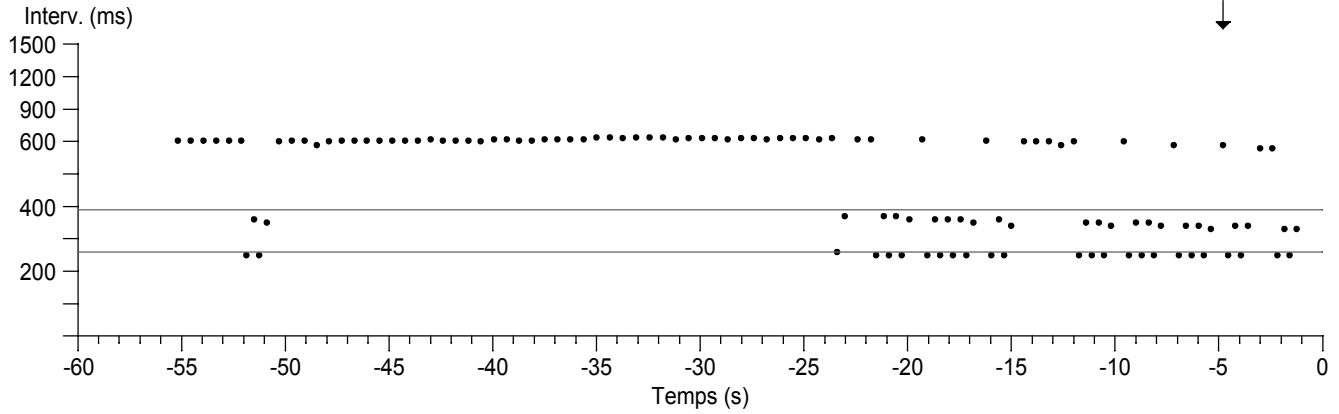

TV non soutenue Episode n° 324

Dispositif : **Protecta XT VR D354VRM**



Numéro de série :

Date de la visite : **27-Sep-2016 11:34:51**

Patient :

ID :

Episode N°324 Vitesse défilement : 25.0 mm/s

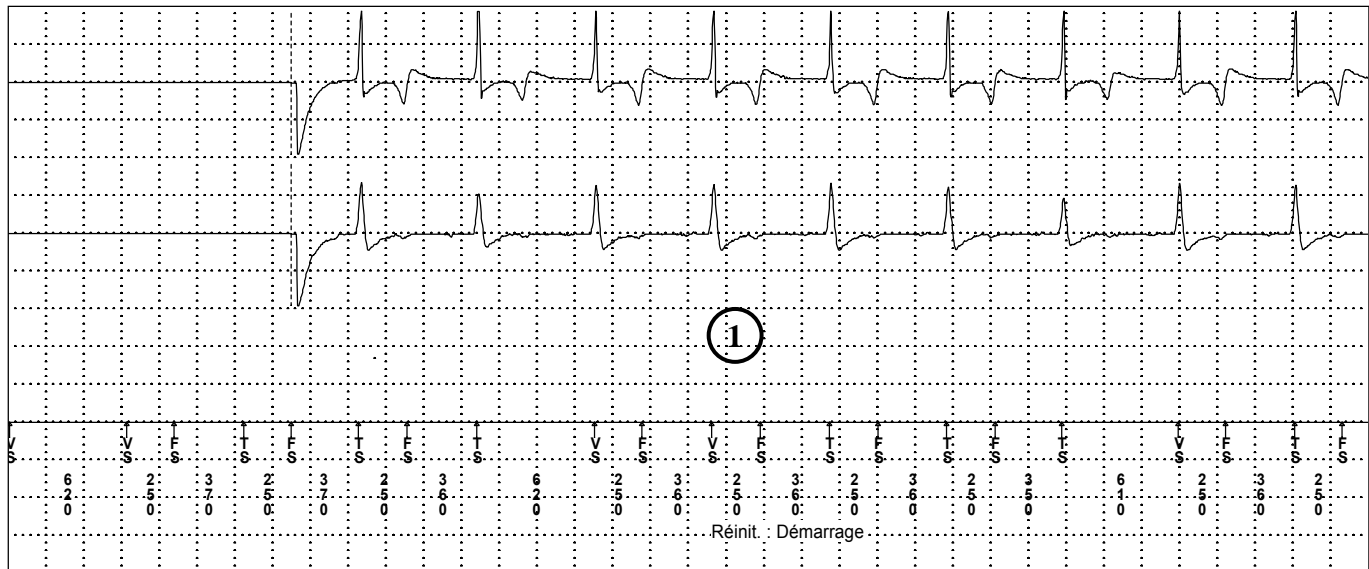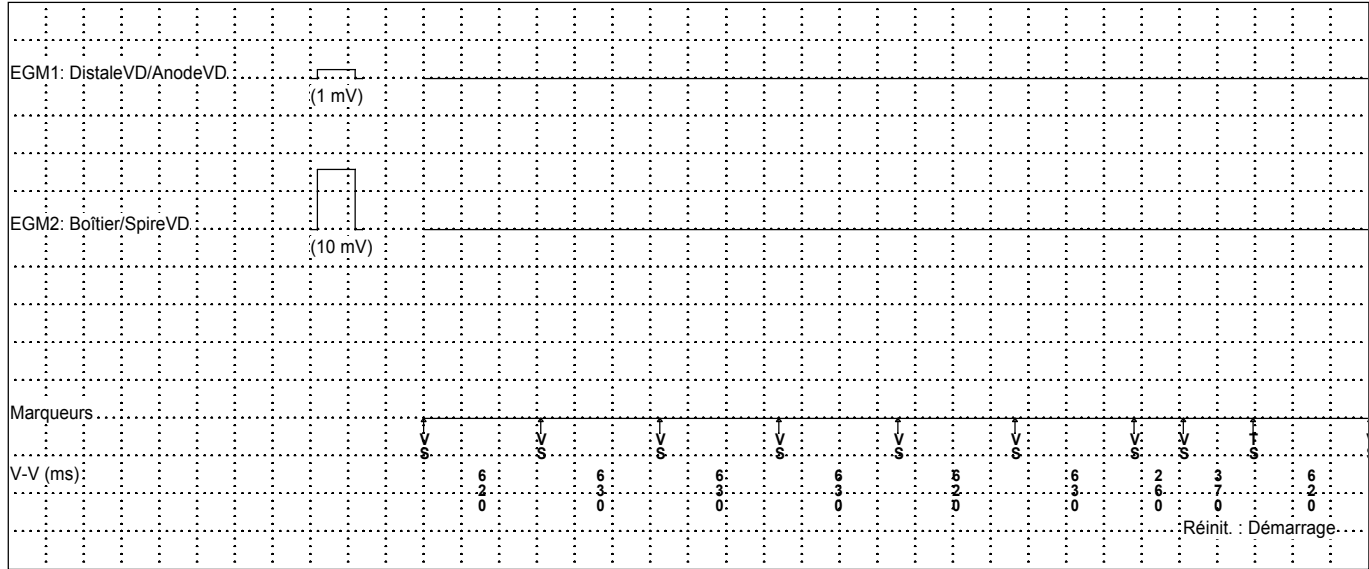

TV non soutenue Episode n° 324

Dispositif : **Protecta XT VR D354VRM**

Numéro de série :

Date de la visite : **27-Sep-2016 11:34:51**

Patient :

ID :

Episode N°324 Vitesse défilement : 25.0 mm/s

